



# LOGOMANUAL

stručný grafický manuál BMT Medical Technology s.r.o.

# ÚVOD

Grafický logomanuál slouží jako základní informační zdroj o logu BMT Medical Technology s.r.o. a jeho použití. Je nezbytné jej do důsledků dodržet, a tím zabránit možnému poškození loga. Jednotné používání logotypu zaručuje ucelenou prezentaci ve všech oblastech a je důležitou součástí vytváření profesionální firemní identity.




Z důvodu zestručnění informací tento logomanuál neobsahuje zakázané varianty použití loga. Jednoznačně tak proto platí jednoduché a pevné pravidlo:

**CO NENÍ V MANUÁLU VÝSLOVNĚ POVOLENO, JE ZAKÁZÁNO.**


# DEFINICE FIREMNÍCH BAREV

Jako firemní barvy jsou primárně užívány modrá, stříbrná a šedá. Samotná stříbrná barva, která tvoří podklad šedého obdélníku zakomponovaného v logu BMT Medical Technology s.r.o. je nahraditelná 30% šedou. Stín čtverce na hraně je 80% černá barva.

## PRIMÁRNÍ BARVY:

	<b>Pantone 285 CV</b>	CMYK: 91 / 43 / 0 / 0 web: #0076BE
	<b>Pantone Black (80%)</b>	CMYK: 0 / 0 / 0 / 80 web: #504F53
	<b>Pantone 877 CV (stříbrná)</b> Možno nahradit Pantone Cool Gray 4 = 30% šedá	CMYK: 0 / 0 / 0 / 30 web: #C3C5C8

## POUŽITÍ BAREV V LOGU:

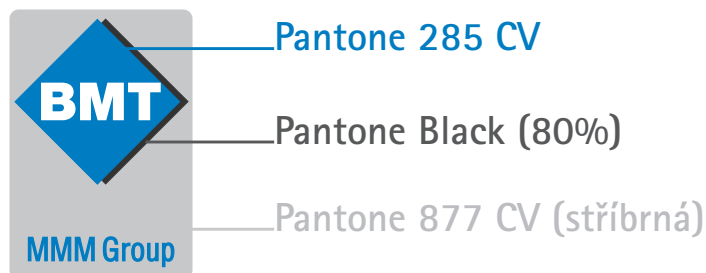

# DOPLŇKOVÉ BARVY

Pro kompletní přehled uvádíme i používané doplňkové barvy, které se používají v tiskovinách a ostatních materiálech společnosti. Uvědoměle a šetrně používané sekundární barvy mohou podtrhnout barevné klima typické pro podnik, aniž by jej rušily. Tím je i při částečném zvýraznění zajištěna harmonie celkového obrazu. Sekundární barvy se mohou používat k optické podpoře fotografií, tabulek, typografie a grafiky.

## DOPLŇKOVÉ BARVY POUŽÍVANÉ V TISKOVINÁCH BMT:

	CMYK: 0 / 0 / 100 / 0	web: #FFED00
	CMYK: 10 / 40 / 100 / 0	web: #E69F00
	CMYK: 0 / 70 / 90 / 0	web: #EC6519
	CMYK: 20 / 100 / 50 / 0	web: #C90051
	CMYK: 70 / 100 / 0 / 8	web: #6C0E7F
	CMYK: 90 / 30 / 0 / 20	web: #0075B1
	CMYK: 40 / 0 / 0 / 20	web: #89BBD5
	CMYK: 94 / 0 / 45 / 15	web: #00948E
	CMYK: 60 / 10 / 85 / 0	web: #7DAD49

# OCHRANNÁ ZNÁMKA

Společnost BMT Medical Technology s.r.o. má registrovanou celosvětovou ochrannou známku.

Její podoba je vyobrazena níže.

Tato ochranná známka je nedílnou součástí loga společnosti a v žádném případě nesmí být jakýmkoliv způsobem upravována.



# ZÁKLADNÍ PODOBA LOGA

VE VŠECH PŘÍPÁDECH, JE-LI TO MOŽNÉ, SE PREFERUJE UŽITÍ NĚKTERÉ Z TĚCHTO ZÁKLADNÍCH VARIANT LOGA.

Volba barevného provedení závisí na možnostech technologického zpracování.

**Preferováno je však vždy na prvním místě plnobarevné zobrazení loga.**

Aplikace je možná jak na světlé, tak i na tmavé pozadí při zaručení dobrého překrytí tmavého pozadí.



Plnobarevná varianta



Stupně šedi



Minimální použitelná výška logotypu je 10 mm.

# DALŠÍ VARIANTY LOGA



V případě, že je zapotřebí užití jiné varianty, je zde možnost použít některou z následujících možností. Základním specifickým prvkem je vyobrazení obdélníku se zaoblenými rohy pomocí linky vedené po obvodu tohoto prvku. Odpadá tak použití stříbrné, resp. šedé barvy na pozadí obdélníku se zaoblenými rohy. Aplikace těchto variant je možná pouze na jednobarevné světlé pozadí.

## POUŽITÍ:

Tyto verze se užívají zásadně pouze v případech, kdy nelze aplikovat základní plnobarevnou verzi loga, případně základní verzi ve stupních šedi (viz. strana 5 tohoto manuálu).

Typické případy aplikace těchto variant:


Sítotiskový potisk na reklamní předměty, ražba, gravírování, řezaná plotrová grafika atd.



Dvoubarevná  
varianta



Jednobarevná  
varianta, modrá

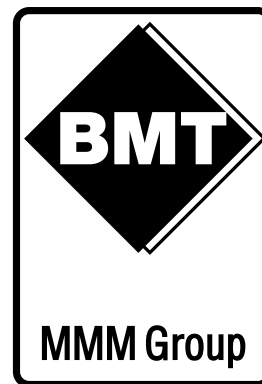

Jednobarevná  
varianta, černá




Minimální použitelná výška logotypu je 10 mm.

# INVERZNÍ POUŽITÍ LOGA



Inverzní varianta loga se používá v těch případech, kdy je podklad určený pro umístění loga příliš tmavý a není možné umístit plnobarevnou variantu loga tak, aby bylo zajištěno bezchybné překrytí pozadí.

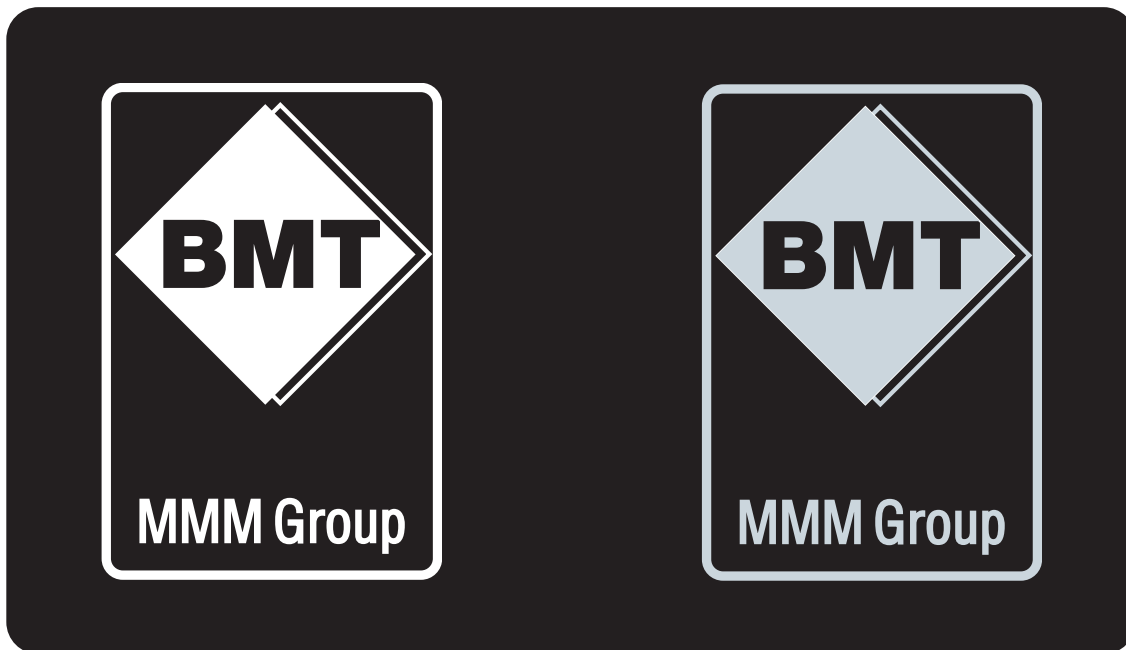

Inverzní bílá varianta

Inverzní stříbrná (šedá) varianta

Minimální použitelná výška logotypu je 10 mm.



# PÍSMO



Písmo používané v tiskovinách BMT Medical Technology s.r.o. má název **Rotis Sans Serif Std.**

Písmena BMT v logotypu společnosti, která jsou vysázena fontem Arial Black, MMM Group je v logu vysázeno písmem Univers 57 Condensed.

Fonty v logotypu nesmí být nahrazován alternativními písmy.

BMT = Arial Black



MMM Group = Univers 57 Condensed



# DOPISNÍ PAPÍR

Jako firemní papír se používá papír „Soporset ofset premium“, společnosti Igepa.

Gramáž firemního papíru je 90 g/m<sup>2</sup>.

Umístění loga je v pravém horním rohu, 10 mm od horního okraje a 20 mm od pravého okraje papíru.

Logo je na firemním papíru tištěno ve své plnobarevné variantě, bez použití stříbrné barvy, která je zde nahrazena alternativní šedou. Výška loga je 30 mm.

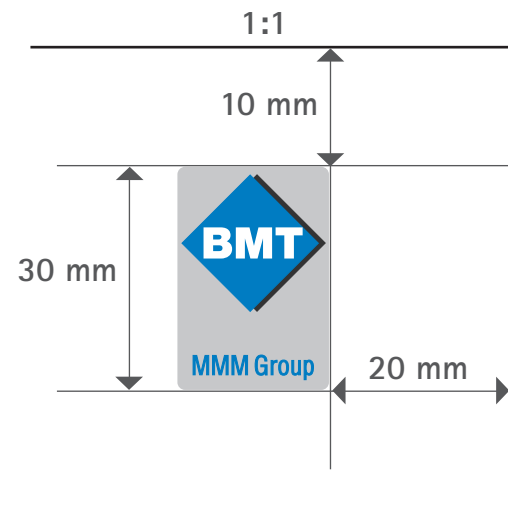



# VIZITKA

Firemní vizitka má klasický formát š: 90 x v: 50 mm. Logo na vizitce je umístěno v nejvyšší možné plnobarevné variantě, včetně stříbrné barvy. Velikost loga je na výšku 27 mm. Umístění loga je 6 mm od horního i pravého okraje vizitky.

Použitý papír na tisk vizitek je „Profisilk“ společnosti Igepa. Gramáž papíru je 300 g/m<sup>2</sup>

1:1

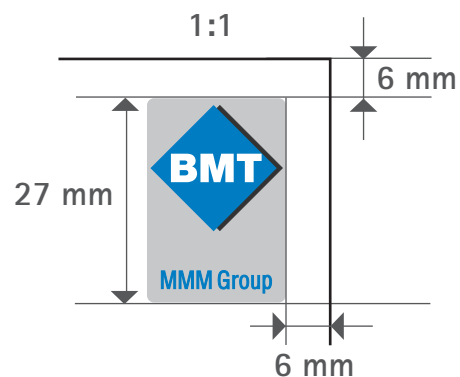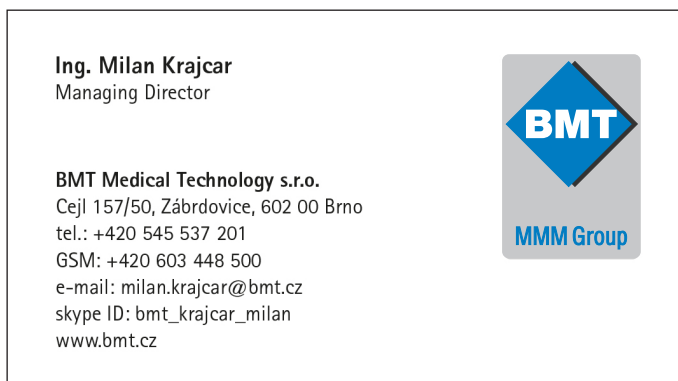



BMT Medical Technology s.r.o. - 2022

logomanual\_05/2022-V03\_BMT\_PR